

USER GUIDE





PROMPT Flex 産後出血モジュール

品番: 180101

インデックス

商品構成	2
安全と清掃の手引き	3
セットアップ	4
PROMPT Flex 母体の準備	4
• 産後出血モジュールを取り付ける	6
• 疑似血液供給タンク、腹壁を取り付ける	7
子宮を膨らます	8
• 子宮の出血を再現する	9
トレーニング	10
シミュレーションの開始と終了	10
清掃と保管	11

商品構成





安全と清掃の 手引き

PROMPT Flex 産後出血モジュールを使用される前に、この安全の手引きを確認してください。

DO's



- このガイドのすべての指示に従ってください。
- このガイドは大切に保管してください。
- すべての警告に注意してください。

・付属の疑似血液のみ使用してください。非 推奨品の使用はシミュレーターの劣化や損 傷の原因となります。





メーカーが提供するアタッチメント以外は使用しないでください。

DONT's

しないでください。

熱源の近くに設置したり、炎にさらしたり、 火の近くで使用したりしないでください。本製品の近くまたは上で可燃性の溶剤を使用



• 常に手袋を着用し、貴金属はすべて外してください。爪や指輪などの鋭利な表面は、製品 損傷の原因となります。



・貴金属をつけたまま使用しないでください。

• 使用後は毎回、柔らかい布やスポンジを中性 洗剤を混ぜたお湯につけ、しっかり絞った後、 やさしく拭いてください。母体の表面につい た擬似血液等の汚れをきれいに取り除いてく ださい。



・製品を分解したり修理しようとしたりしないでください。製品の点検や修理は販売代理店に連絡をしてください。




保管と移動



• 人身事故や製品の破損を防ぐため、輸送・保管時には必ず適切な梱包・固定を行ってください。

セットアップ


PROMPT Flex 母体の準備 腹壁を脱着する

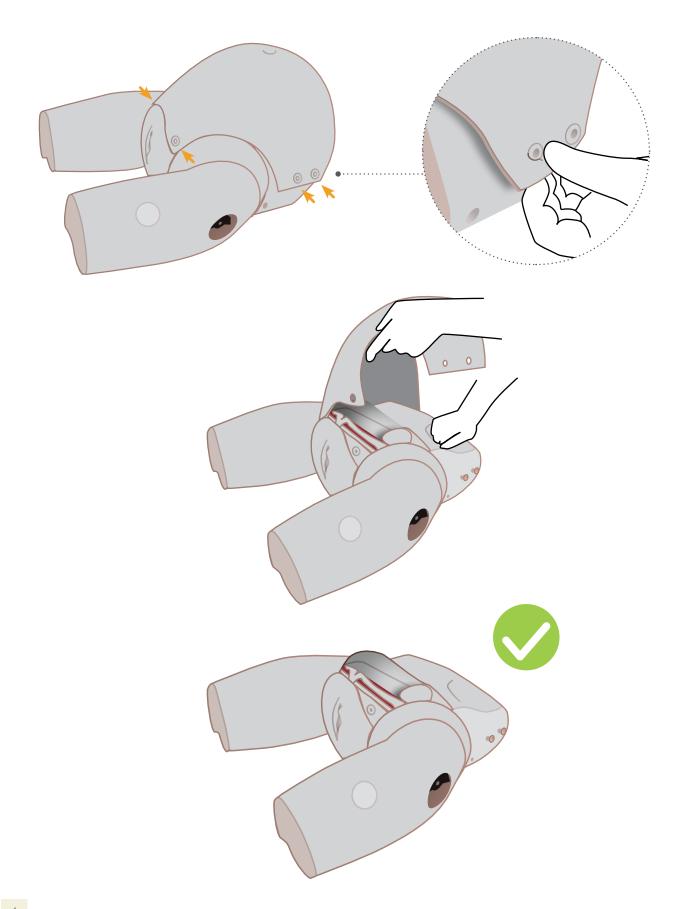


セットアップ


PROMPT Flex 母体の準備 PROMPT FlEX 分娩用の骨盤リング、子宮頸の取り外し


1

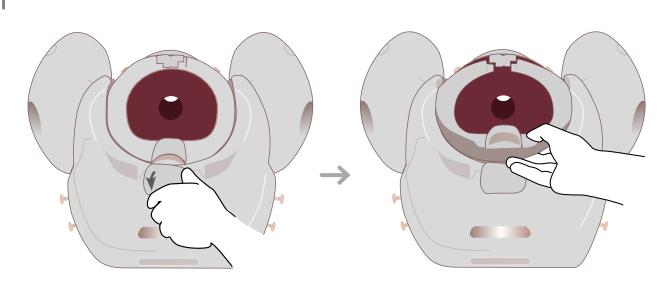

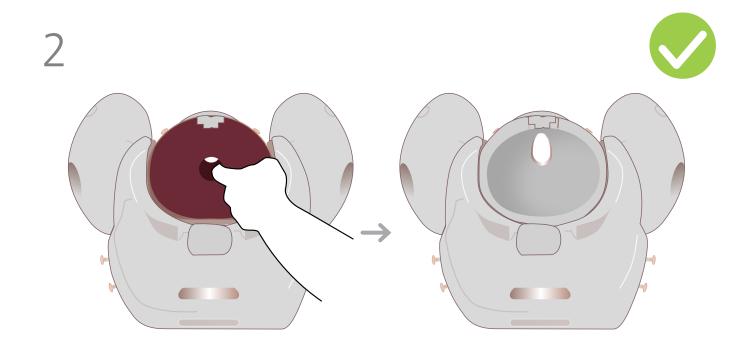


産後出血モジュールを取り付ける

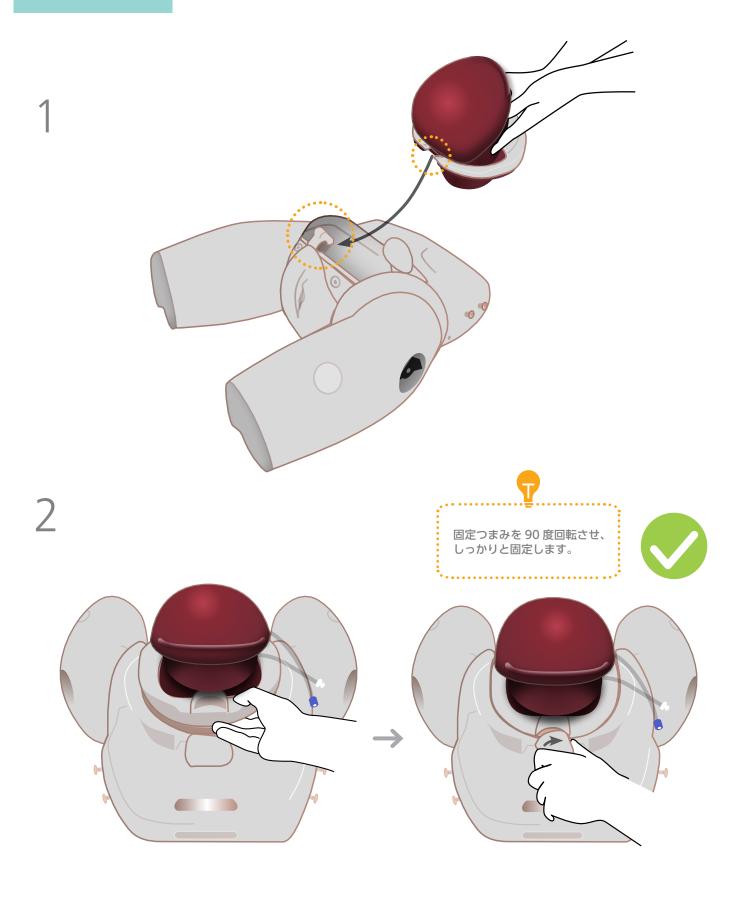

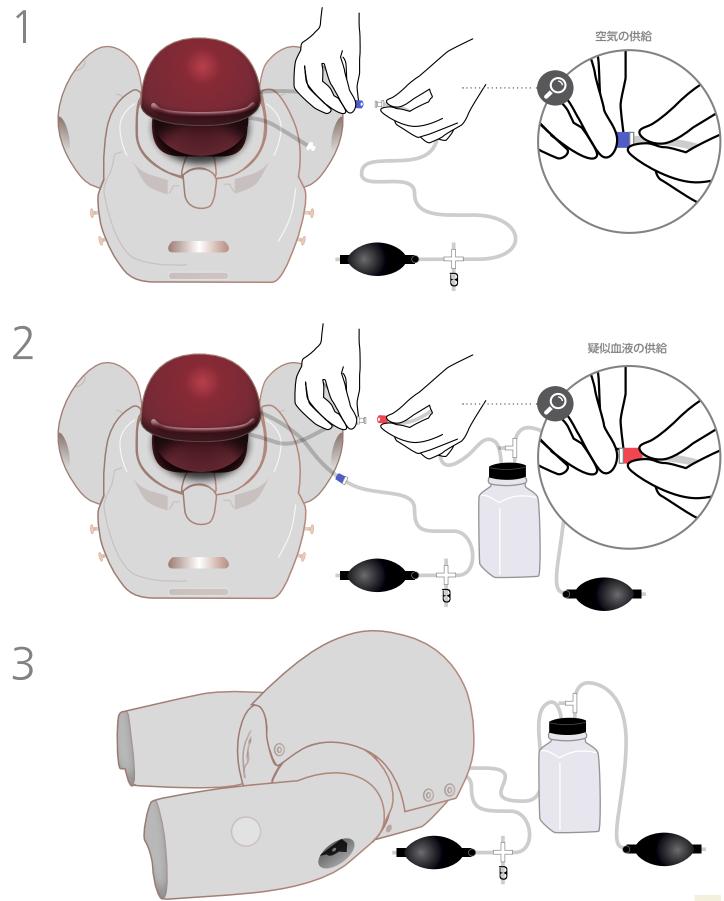


子宮を膨らます

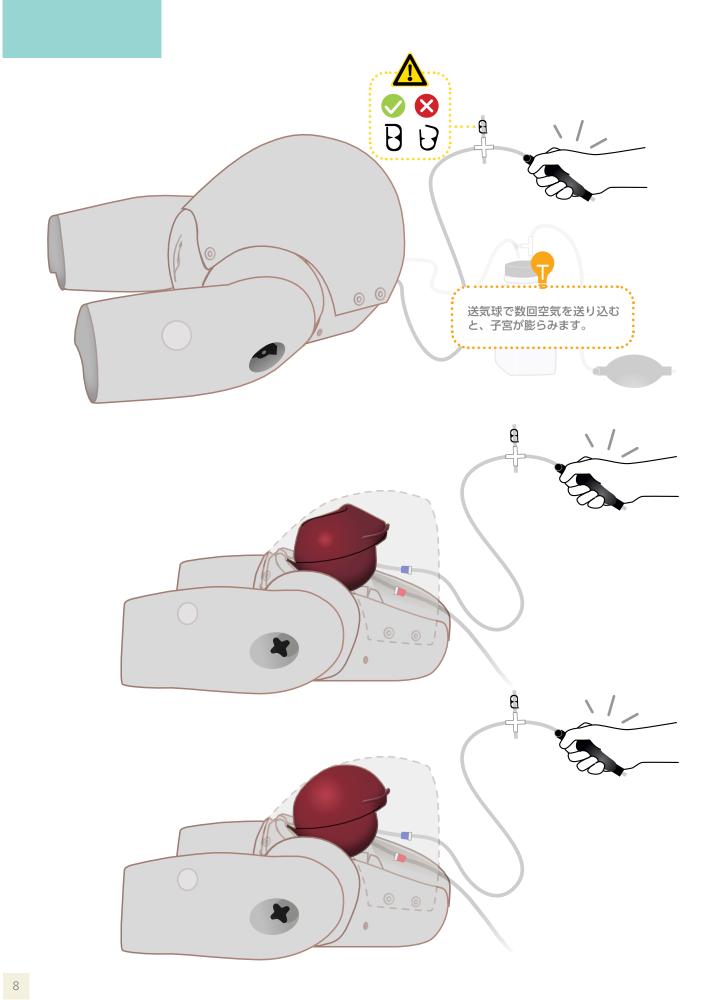

セットアップ


子宮の出血を再現する

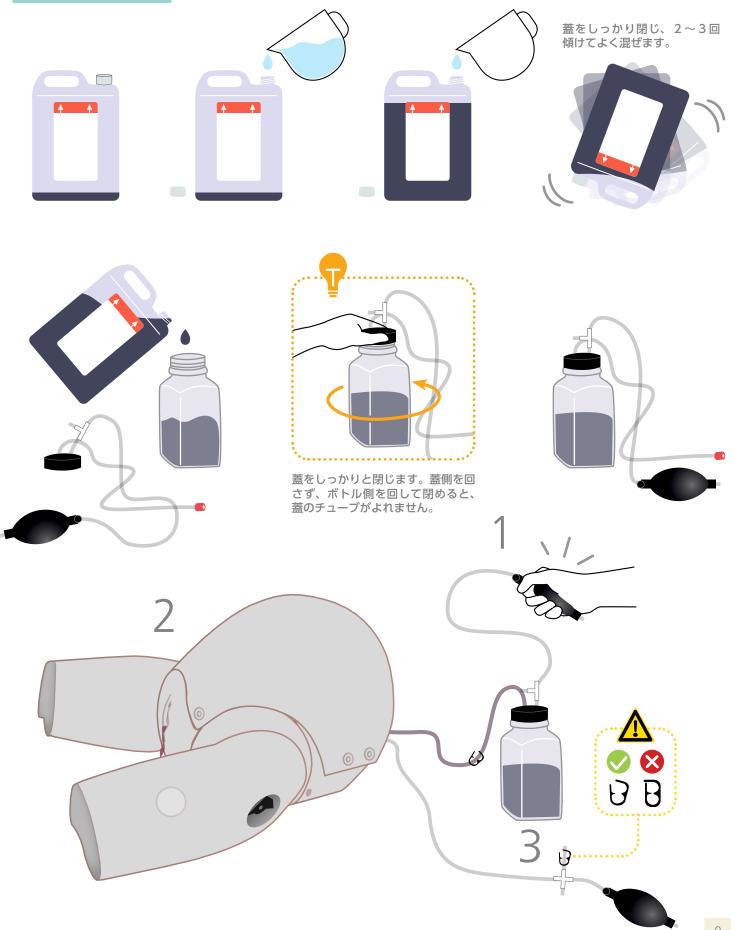


シミュレーションの開始と終了



腹壁を装着し、子宮マッサージを行うことができます。子宮はマッサージを行う度に空気がチューブから抜けるようになっています。

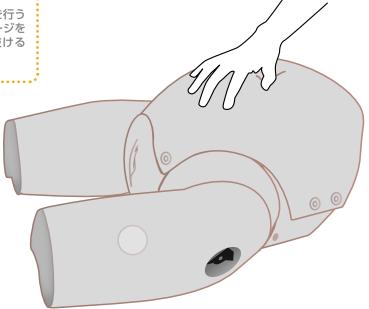


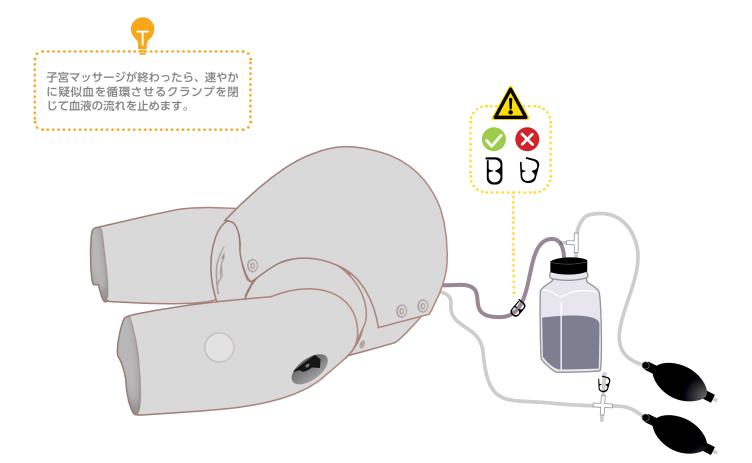

清掃と保管





シミュレーション後の膣内の擬似血 液は、空のシリンジで取り除きボトル に戻してください。

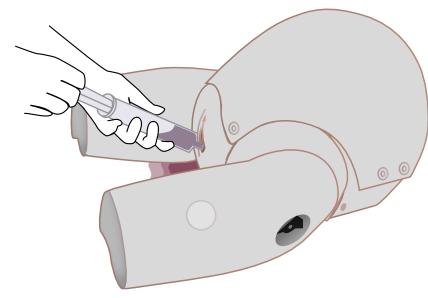







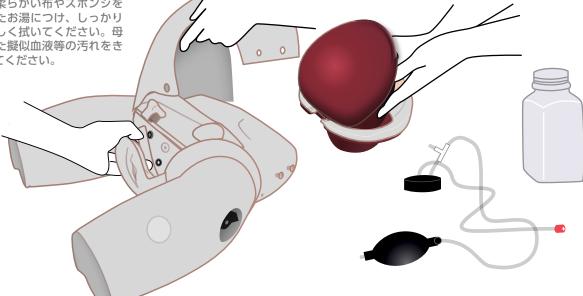

YOU MAY ALSO BE INTERESTED IN...

180110

下腿(膝関節モジュール付)



180300

PROMPT Flex 帝王切開 IFH モジュール



180100

PROMPT Flex 分娩トレーナー スタンダードセット



180102

PROMPT Flex 内診モジュール



180310

PROMPT Flex 器械分娩 AVB モジュール





Part No: 365-014

第6版 2022年5月 ©2022 Limbs & Things

NUS 日本ライトサービス株式会社 Nihon Light Service, Inc.

- 医学教育機器事業部 -

- ♥ 〒 113-0033 東京都文京区本郷 2-3-9 ツインビュー御茶の水 2F
- **C** 03-3815-2354
- **a** 03-3818-6843
- igaku@nlsinc.co.jp

 igaku@nlsinc.co.jp
- www.medical-sim.jp