


基本操作ガイド

qubeCTG

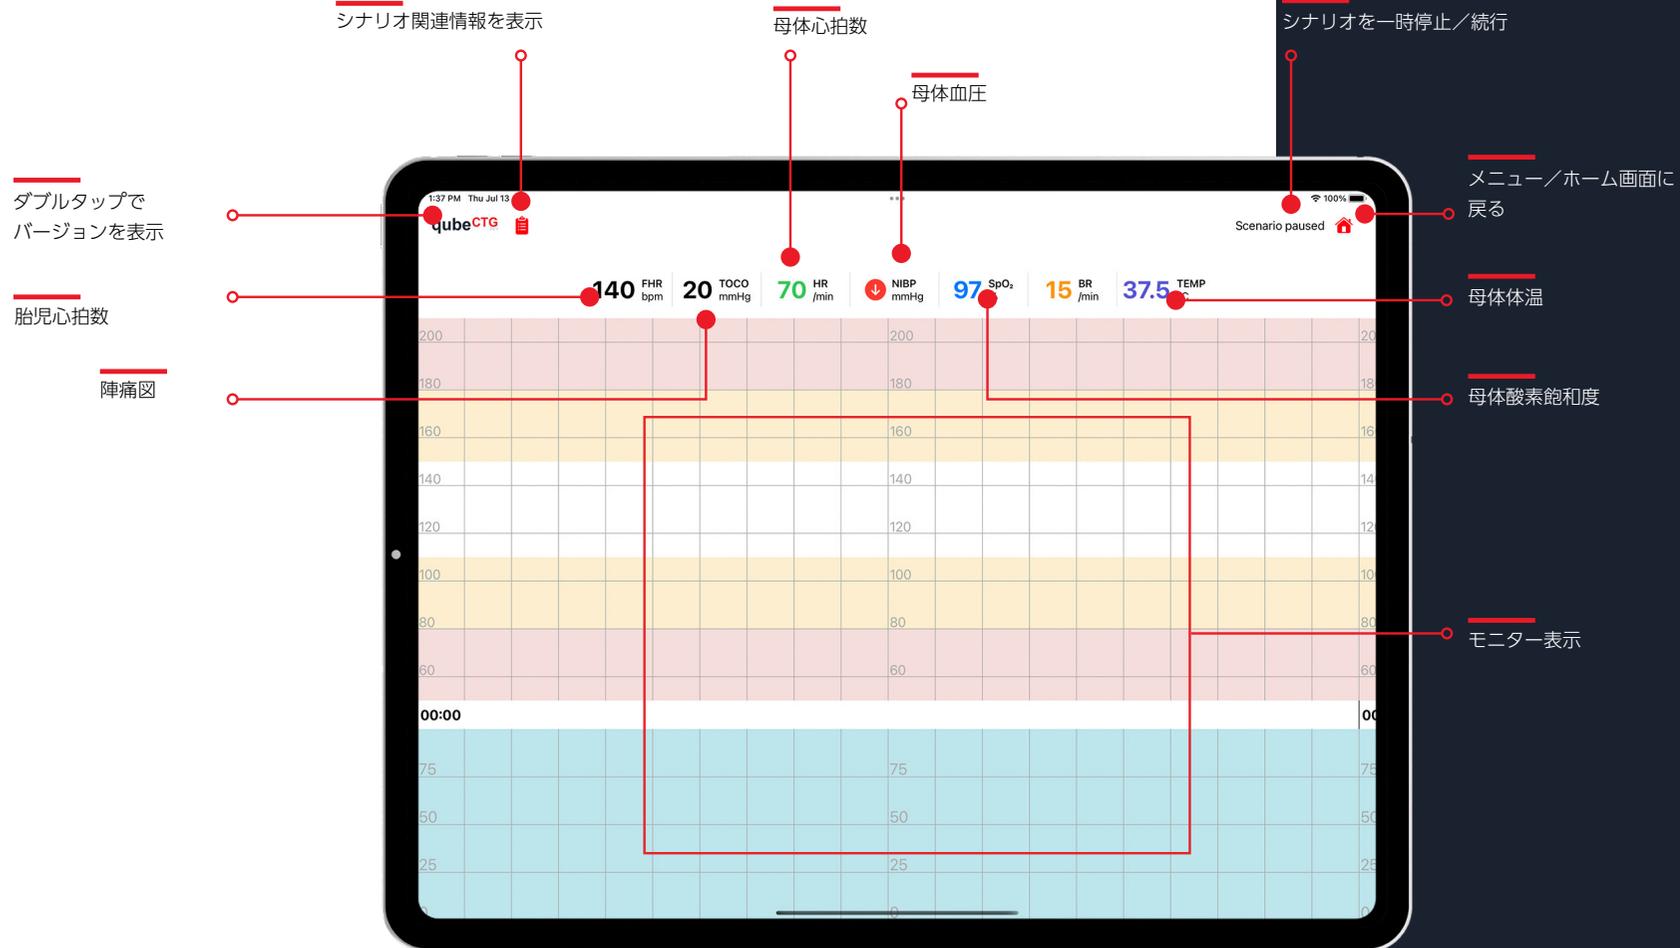

基本操作ガイド

qubeCTG

メニュー／ホーム画面に戻る

変更なし

陣痛図と胎児心拍数の
基線を設定する

ソフトウェアバージョン
の表示

シナリオに
名前を付ける／名前を変更する

ブリーフィング情報

シナリオに
メディアを追加する

メモを追加する

陣痛図と胎児心拍数の接触品質を
表示する

陣痛図と胎児心拍数の波形と形状を
設定／変更する

陣痛図と胎児心拍数の変動性を
設定する

再生／一時停止

シナリオの速度

進行状況バー

00:00 00:10 00:00:00

70 97
122 15
82 37.5
none none

None Baseline Variability Shapes Contact Notes

200 180 160 140 120 100 80 60 0

200 180 160 140 120 100 80 60 0

75 50 25 0

75 50 25 0